


H26-S2(2)およびH24-4のダイオキシン類の測定結果について

ダイオキシン類測定のプロフロー(抜粋)*

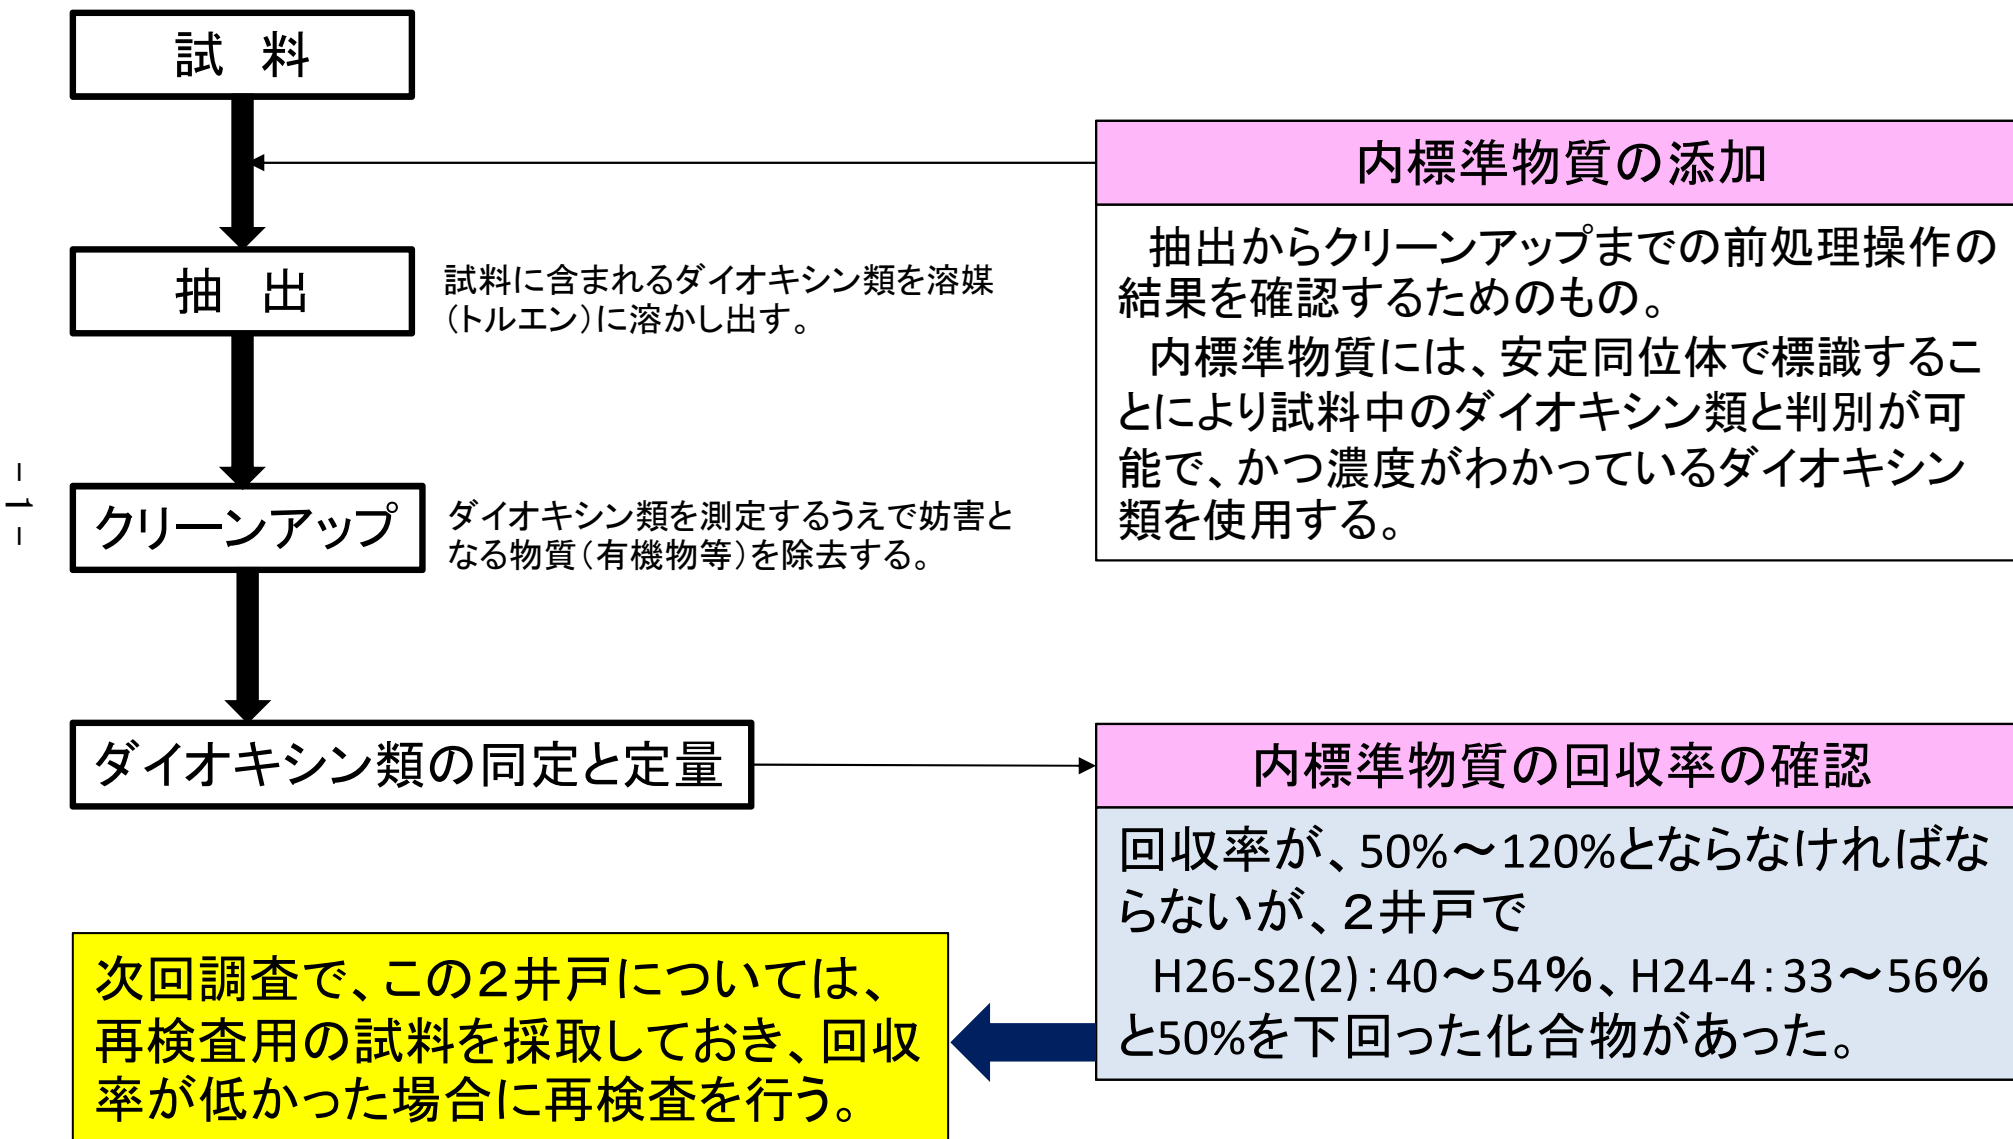

*JIS K 0312『工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法』より